



દદીર્ અને સંભાળદાતા શિક્ષણ

તમારા બાઇલરી ડરેઇનેજ કેથેટર વિશે

આ માહિતી તમને એમએસકે ખાતે તમારા પિત્ત (Pitt) નિકાલ નિવેશિકા ગોઠવણીના ઓપરેશન માટે તૈયાર થવામાં મદદ કરશે. તે ઘરે તમારી નિવેશિકાની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે પણ સમજાવે છે.

તમારી પિત્ત પરણાલી વિશે

પિત્ત (બાઇલ) એ તમારા લિવર દ્વારા બનાવવામાં આવતું એક પરવાહી છે. તે તમને ખોરાકને પચાવવામાં (તોડવામાં) મદદ કરે છે. પિત્ત તમારા ચક્રત દ્વારા તમારી પિત્ત નળીઓમાંથી અને તમારા નાના આંતરડામાં વહે છે.

તમારી પિત્ત નળી ઘાયલ પેશીઓ અથવા ગાંઠો દ્વારા સંકુચિત અથવા અવરોધિત થઈ શકે છે. જ્યારે આવું થાય છે, ત્યારે પિત્ત તમારા નાના આંતરડાના પર્યથમ ભાગમાં વહી શકતું નથી, જેને પક્વાશય (pakvashay) કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તમારી પિત્ત નળી સંકોચાય છે અથવા અવરોધિત થાય છે, ત્યારે તે તમારા ચક્રતમાં પિત્તના નિમારણનું કારણ બને છે (આકૃતિ 1 જુઓ).

તમારા ચક્રતમાં પિત્તનું નિમારણ થવાનું કારણ:

- રોગનો ચેપ
- ઉબકા (એવું લાગે છે કે તમને ઉલટી થશે)
- ઉલ્ટી (ઉબકા આવવા)
- તાવ
- ખંજવાળ
- કમળો (જ્યારે તમારી ત્વચા અને તમારી આંખો પીળી દેખાય)

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા વિશે

જો તમારી પિત્ત નળી અવરોધિત હોય, તો તમારા ડૉક્ટર તમને પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મૂકવાની ભલામણ કરી શકે છે. આ એક પાતળી, લવચીક નળી છે જે તમારા યકૃતમાંથી પિત્તને બહાર કાઢે છે.

જુદી જુદી 3 રીતે પિત્ત તમારા લિવરમાંથી વહાવી શકાય છે. તમારા ઓપરેશન પહેલાં તમારા ડૉક્ટર તમારી સાથે આ વિશે વાત કરશે.

- એક આંતરિક-બાહ્ય પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા તમારી ત્વચામાંથી પસાર થાય છે અને તમારી પિત્ત નળીઓમાં જાય છે. તેને બ્લોકેજની આજુબાજુ મૂકવામાં આવશે (આકૃતિ 2 જુઓ).

આ ઓપરેશન પછી, નિવેશિકાનો એક છેડો તમારા નાના આંતરડાની અંદર મુકવામાં આવશે. નિવેશિકાનો બીજો છેડો તમારા શરીરમાંથી બહાર આવશે. તે નિકાલ બેગ સાથે જોડાયેલ હશે જે તમારા યકૃતમાંથી પિત્ત એકત્રિત કરે છે.

આંતરિક-બાહ્ય પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા પિત્તને 2 દિશામાં વહેવા દે છે. પિત્ત તમારા નાના આંતરડામાં (જેને આંતરિક નિકાલ કહેવામાં આવે છે) અથવા તમારી નિકાલ બેગમાં વહી શકે છે (જેને બાહ્ય નિકાલ કહેવામાં આવે છે).

આકૃતિ 2. ઇન્ટર્નલ-એક્સ્ટર્નલ બાઇલરી ડ્રેઇનેજ કેથેટર

આકૃતિ 2. ઇન્ટર્નલ-એક્સ્ટર્નલ બાઇલરી ડ્રેઇનેજ કેથેટર

- એક બાહ્ય પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા તમારી ત્વચામાંથી પસાર થાય છે અને તમારી પિત્ત નળીઓમાં જાય છે. તેને બ્લોકેજની ઉપર મૂકવામાં આવશે (આકૃતિ 3 જુઓ).

આ ઓપરેશન પછી તમારા શરીરમાંથી નિવેશિકા નીકળશે. નિવેશિકા એક નિકાલ બેગ સાથે જોડાયેલ હશે જે તમારા ચક્રતમાંથી નીકળેલા પિત્તને એકત્રિત કરે છે.

- પિત્ત સ્ટેન્ટિંગ અવરોધિત પિત્ત નળીને ખુલ્લી રાખવા માટે સ્ટેન્ટ (પાતળી, ધાતુની નળી)નો ઉપયોગ થાય છે. સ્ટેન્ટ સાથે અવરોધિત પિત્ત નળી ખોલવાથી પિત્ત તમારા ચક્રતમાંથી બહાર નીકળી જાય છે.

આ ઓપરેશન પછી તમારા શરીરમાંથી નાની નિવેશિકા નીકળી શકે છે. જ્યારે તમારા ડૉક્ટર જુએ છે કે તમારું સ્ટેન્ટ સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તેઓ નિવેશિકા બહાર કાઢશે.

તમારું પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા અથવા પિત્ત સ્ટેન્ટ ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજિસ્ટ (જેને આઇઆર ડૉક્ટર પણ કહેવામાં આવે છે) દ્વારા ફીટ કરવામાં આવશે. આઇઆર ડૉક્ટર એ એક ડૉક્ટર છે, જેમણે છબી-માગર્ફશિર્ત ઓપરેશનો કરવાની વિશેષ તાલીમ લીધી છે.

જો તમને પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મૂકવામાં આવી હોય, તો તેને નિકાલ એકતિર્ત કરવા માટે બેગ સાથે જોડવામાં આવશે. તમારા આઇઆર ડૉક્ટર તમને જણાવશે કે તમારે કેટલા નિકાલની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ.

તમે તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મેળવો તે પહેલાં શું કરવું

તમારી દવાઓ વિશે પૂછો

તમારી કાયરપરણાલી પહેલાં તમારે તમારી કેટલીક સામાન્ય દવાઓ લેવાનું બંધ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. કઈ દવાઓ લેવાનું બંધ કરવું તમારા માટે સલામત છે તે વિશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો.

અમે નીચે કેટલાક સામાન્ય ઉદાહરણો સામેલ ક્યાર છે, પરંતુ અન્ય છે. એ સુનિશ્ચિત કરો કે તમારી સંભાળ લેનારી ટીમને તમે લો છો તે તમામ પિરસિક્કરપ્શન અને ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ વિશે જાણો છે. પિરસિક્કરપ્શન દવા તે છે જે તમે ફક્ત આરોગ્યસંભાળ પરદાતાના પિરસિક્કરપ્શન સાથે જ મેળવી શકો છો. ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ એવી દવા છે જે તમે પિરસિક્કરપ્શન વિના ખરીદી શકો છો.



તમારી કાયરપરણાલી પહેલાંના દિવસોમાં તમારી દવાઓ યોગ્ય રીતે લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે તેમ ન કરો, તો અમારે તમારી કાયરપરણાલી રદ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

લોહી પાતળું કરનાર (એન્ટીકોગ્યુલેન્ટ્સ)

લોહી પાતળું કરવું એ એક દવા છે જે તમારા લોહીના ગંઠાવાની રીતને બદલે છે.

જો તમે લોહી પાતળું કરતી દવાઓ લો છો, તો તમારી પરકિર્યા હાથ ધરતા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતાને તમારી પરકિર્યા પહેલાં શું કરવું તે પૂછો. તેઓ તમને તમારી કાયરપરણાલીના અમુક દિવસો પહેલાં દવા લેવાનું બંધ કરવાનું કહી શકે છે. આનો આધાર તમે કેવા પરકારની કાયરપરણાલી કરી રહ્યા છો અને તમે લોહી પાતળું કરવાની દવા કયા કારણસર લઈ રહ્યા છો તેના પર રહેલો છે.

સામાન્ય લોહીને પાતળા કરનારના ઉદાહરણો નીચે દર્શાવ્યા છે. અન્ય પણ છે, તેથી ખાતરી કરો કે તમારી સંભાળ લેનારી ટીમ તમે લો છો તે તમામ દવાઓ વિશે જાણો છે. તમારી સંભાળ ટીમના કોઈ સભ્ય સાથે વાત ક્યાર વિના તમારી લોહી પાતળું કરવાની દવા લેવાનું બંધ કરશો નહીં.

- એપિક્સાબન (Eliquis®)
- એસિપરિન
- સેલેકોક્સિબ (Celebrex®)
- સિલોસ્ટેઝોલ (Pletal®)
- ક્લોપિડોગ્રેલ (Plavix®)
- પ્રેડાક્સા (Pradaxa®)
- ફ્રેગમિન (Fragmin®)
- મેલોક્સીકેમ (Mobic®)
- નોનસ્ટીરોઈડલ બળતરા વિરોધી દવાઓ (NSAIDs), જેમ કે આઇબુપ્રોફેન (Advil®, Motrin®) અને નેપરોક્સેન (Aleve®)
- ટ્રેન્ટાલ (Trental®)
- એફિયન્ટ (Effient®)
- રીવારોક્સાબન (Xarelto®)

- ડિપાયરિડામોલ (Persantine®)
- એડોક્સાબન (Savaysa®)
- એનોક્સાપરીન (લવનોક્સ®)
- ફોન્ડાપરિનક્સ (Lovenox®)
- હેપરિન (તમારી ત્વચાની નીચે આપવામાં આવેલ)
- સલ્ફાસલાઝીન (Azulfidine®, Sulfazine®)
- ટ્રિકાગરેલોર (Brilinta®)
- ટિન્ઝાપારિન (Innohep®)
- વોરફરીન (Jantoven®, Coumadin®)

વાંચો \How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>). તેમાં દવાઓ વિશેની માહિતી છે જે તમારે તમારી સજર્સી પહેલા લેવાની ટાળવી જોઈએ.

ડાયાબિટીસની દવાઓ

જો તમે ઇસ્યુલિન અથવા ડાયાબિટીસની અન્ય દવાઓ લો છો, તો તમારે કાયરપરણાલી પહેલાં શું કરવું તે અંગે પિરસ્ક્રાઇબ કરનાર આરોગ્ય સંભાળ પરદાતાને પૂછો. તમારે તેને લેવાનું બંધ કરવાની અથવા સામાન્ય કરતા અલગ ડોઝ (જથ્થો) લેવાની જરૂર પડી શકે છે. તમારે તમારી કાયરપરણાલી પહેલાં ખાવા-પીવા અંગેની વિવિધ સૂચનાઓનું પાલન કરવાની પણ જરૂર પડી શકે છે. તમારા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતાની સૂચનાઓનું પાલન કરો.

તમારી સંભાળ ટીમ તમારા ઓપરેશન દરમિયાન તમારા લોહીમાં શર્કરાના સ્તરને ચકાસશે.

મૂતરવધરૂક દવા (પાણીની ગોળીઓ)

મૂતરવધરૂક પદાર્થ એ એક દવા છે જે તમારા શરીરમાં પરવાહી નિમારણને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. હાઇડ્રોક્લોરોથાઇઝાઇડ (Microzide®) અને ફ્યુરોસેમાઇડ (Lasix®) મૂતરવધરૂક પદાર્થના ઉદાહરણો છે.

જો તમે મૂતરવધરૂક દવા લો છો, તો તમારી કાયરપરણાલી હાથ ધરી રહેલા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતાને તમારી કાયરપરણાલી પહેલાં શું કરવું તે પૂછો. તમારે તમારી કાયરપરણાલીના દિવસે તેને લેવાનું બંધ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

જો તમને ભૂતકાળમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઇથી એલર્જીક રિએક્શન થયું હોય તો તમારા આઇઆર ડોક્ટરને જણાવો. આ તે ડોક્ટર છે જે તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકાની ગોઠવણીનું ઓપરેશન કરી રહ્યા છે. એલર્જીમાં મદદરૂપ થવા માટે તમારે તમારા ઓપરેશન પહેલાં દવા લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

તમારી ત્વચા પરથી ઉપકરણોને દૂર કરો

તમે તમારી ત્વચા પર ચોક્કસ ડિવાઇસો પહેરી શકો છો. તમારું સ્કેન અથવા પરફિર્યા પહેલાં, ડિવાઇસ બનાવનાર ભલામણ કરે છે કે તમે તમારા ડિવાઇસ ઉતારો:

- સતત ગ્લુકોઝનું મોનિટરિંગ (CGM)
- ઇન્સ્યુલિન પંપ

તમારે તમારા ઉપકરણને બદલવાની જરૂર હોય તે તારીખની નજીક તમારી અપોઇન્ટમેન્ટના શેડ્યૂલ વિશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો. ખાતરી કરી લો કે તમારી પાસે તમારી સ્કેન અથવા પરફિર્યા પછી ચાલુ કરવા માટે તમારી સાથે એક વધારાનું ઉપકરણ છે.

જ્યારે તમારું ડિવાઇસ બંધ હોય ત્યારે તમારા ગ્લુકોઝનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું તે વિશે તમને ખાતરી ન હોઈ શકે. જો એમ હોય તો, તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં, તમારી ડાયાબિટીસની કાળજીનું સંચાલન કરતા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો.

કોઈ તમને ઘરે લઈ જાય તે માટેની વ્યવસ્થા કરવી

ઓપરેશન પછી તમને ઘરે લઈ જવા માટે તમારી સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ હોવો આવશ્યક છે. સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ તે છે જે તમને સલામત રીતે ઘરે પહોંચવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તેમને કોઈ ચિંતા હોય તો તેઓ તમારી સારવાર ટીમનો સંપર્ક કરવા માટે સમથર્ હોવા જોઈએ. તમારા ઓપરેશનના દિવસ પહેલાં તેનું આયોજન કરવાની ખાતરી કરો.

જો તમારી પાસે ઘરે લઈ જવા માટે સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ ન હોય, તો નીચેની કોઈ એક એજન્સીનો સંપર્ક કરો. તેઓ તમારી સાથે ઘરે જવા માટે કોઈને મોકલશે. આ સેવા માટે શુલ્ક છે અને તમારે પરિવહન પૂરું પાડવું પડશે. ટેક્સી અથવા કાર સેવાનો ઉપયોગ કરવો એ બરાબર છે, પરંતુ તમારે હજી પણ તમારી સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિની જરૂર છે.

ન્યૂ યોર્કમાં એજન્સીઓ

વીએનએસ (VNS) સ્વાસ્થ્ય: 888-735-8913

સંભાળ રાખનારા લોકોના સંપર્ક નં.: 877-227-4649

ન્યૂ જર્સીમાં એજન્સીઓ

સંભાળ રાખનારા લોકોના સંપર્ક નં.: 877-227-4649

જો તમે બીમાર હોવ તો અમને જણાવો

જો તમે તમારા ઓપરેશન પહેલાં બીમાર (તાવ, શરદી, ગળામાં દુઃખાવો અથવા ફૂલૂ સહિત) પડો, તો તમારા આઈઆર ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. તમે તેમને સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કોલ કરી શકો છો.

સાંજે 5 વાગ્યા પછી, શનિ-રવિ અને રજાઓમાં, 212-639-2000 પર કોલ કરો. કોલ પર ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી ફેલો માટે પૂછો.

તમારી અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય નોંધો

સ્ટાફનો એક સભ્ય તમારા ઓપરેશન 2 કામકાજના દિવસો પહેલાં તમને કોલ કરશે. જો તમારું ઓપરેશન સોમવારે નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેઓ તમને ગુરુવાર પહેલાં કોલ કરશે. તેઓ તમને જણાવશે કે તમારા ઓપરેશન માટે કયા સમયે હોસ્પિટલમાં જવું જોઈએ. તેઓ તમને એ યાદ પણ કરાવશે કે ક્યાં જવું.

તમારા ઓપરેશનની તારીખ, સમય અને સ્થાનને લખવા માટે આ વિસ્તારનો ઉપયોગ કરો:

જો તમને તમારા ઓપરેશનના એક કામકાજના દિવસના મધ્યાહ્નને (બપોરે 12 વાગ્યે) સુધીમાં કોલ ન આવે, તો 646-677-7001 પર કોલ કરો. જો કોઈ કારણસર તમારે તમારી પરોસીઝર રદ કરવાની જરૂર પડે તો જે સ્વાસ્થ્ય સારવાર પરદાતાએ તમારા માટે તેને નિધારિત કરી હતી એમને કોલ કરો.

તમે તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મેળવો તે પહેલાંના દિવસે શું કરવું

ખાવા-પીવા માટેની સૂચનાઓ



તમારી સજર્રીની આગલી રાત્રે મધરાતેથી (રાત્રે 12 વાગ્યે) ખાવાનું બંધ કરી દો. જેમાં હાડર્ કેન્ડી (પિપરમેન્ટ) અને ચ્યુઈંગમનો સમાવેશ થાય છે.

જો તમારા આરોગ્ય પરદાતા તમને મધ્યરાત્રિ પહેલાં જમવાનું બંધ કરવાનું કહ્યું હોય, તો તેમની સૂચનાઓનું પાલન કરો. કેટલાક લોકોએ સજર્રી પહેલાં લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ (જમવું નહીં) કરવાની જરૂર હોય છે.

જે દિવસે તમને તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મળશે તે દિવસે શું કરવું

ખાવા-પીવા માટેની સૂચનાઓ

મધરાત (રાત્રે 12 વાગ્યાથી) તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં સુધી, નીચે દર્શાવેલા પરવાહી જ પીવો. બીજું કંઈ ખાવું કે પીવું નહીં. તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં પીવાનું બંધ કરો.

- પાણી.
- સ્વચ્છત સફરજનનો રસ, સ્વચ્છત દરૂક્ષનો રસ અથવા સ્વચ્છત કર્નેબેરીનો રસ.

- ગેટોરેડ અથવા પાવરેડ.
- બ્લેક કોફી કે સાદી ચા. ખાંડ ઉમેરવી ઠીક છે. બીજું કશું ઉમેરશો નહીં.
 - કોઈપણ પરકારનું દૂધ અથવા કરીમર કોઈપણ માત્રામાં ઉમેરશો નહીં. જેમાં છોડ આધારિત દૂધ અને કરીમરનો સમાવેશ થાય છે.
 - મધ ઉમેરશો નહીં.
 - ફ્લેવરવાળા સીરપ ઉમેરશો નહીં.

જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો આ પીણાંમાં કેટલી માત્રામાં ખાંડ છે તેના પર ધ્યાન આપો. જો તમે આ પીણાંમાં ખાંડ રહિત, ઓછી ખાંડવાળું અથવા ખાંડ વગરના વર્ગના સમાવેશ કરો છો, તો તમારા રક્તમાં ખાંડનાં સ્તરને નિયંત્રિત કરવાનું સરળ બનશે.

સર્જરી પહેલાં હાઇડ્રેટેડ રહેવું મદદરૂપ થાય છે, તેથી જો તમને તરસ લાગી હોય તો પાણી પીવો. તમારી જરૂરિયાત કરતા વધારે પીવું નહીં. તમારી સર્જરી દરમિયાન તમને ઇન્ટ્રાવેનુસ (IV) પરવાહી આપવામાં આવશે.



તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં પીવાનું બંધ કરો. આમાં પાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

યાદ રાખવાની બાબતો

- તમારા ઓપરેશનની સવારે તમારી દવાઓ લેવા માટે તમારા આરોગ્ય સંભાળકર્તાઓની સૂચનાઓનું પાલન કરો. પાણીના થોડા નાના ઘૂંટડા સાથે આને લેવી ઠીક છે.
- બોડી કરીમ, લોશન અથવા પેટ્રોલિયમ જેલી (વેસેલિન®) લગાવશો નહીં. તમે ડિઓડરન્ટ્સ અને ચહેરાના મોઇશ્યરાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આંખોમાં કોઈ મેક-અપ ના કરો.
- ધાતુની કોઈ પણ વસ્તુ ન પહેરવી. શરીરના વીધેલા સહિત તમામ દાગીના ઉતારી લો. તમારા ઓપરેશન દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો જો ધાતુને સ્પર્શે તો તમે બળી શકો છો.
- કિંમતી ચીજવસ્તુઓ ઘરે જ રાખી દો.
- જો તમે કોન્ટ્રેક્ટ લેન્સ પહેરો છો, તો શક્ય હોય તો તેના બદલે તમારા ચશ્મા પહેરો. જો તમારી પાસે ચશ્મા ન હોય, તો તમારા કોન્ટ્રેક્ટ લેન્સ માટે કવર લાવો.
- કેટલાક આરામદાયક અને ઢીલા ફિટિંગવાળા કપડાં પહેરો.
- જ્યારે તમારા ઓપરેશનનો સમય થાય ત્યારે, ત્યારે તમારે કોઈ પણ શર્વણ ઉપકરણો, દાંતર, કૃતિર્મ ઉપકરણો, વિગ અને ધામિરૂક વસ્તુઓને કાઢી નાખવી જોઈએ.

શું સાથે લાવવું

- પિર્સિક્સ્પ્રશન અને ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ, પેયો અને કરીમ સહિત તમે ઘરે લો છો તે તમામ દવાઓની યાદી.
- શ્વાસની સમસ્યાઓ માટેની દવાઓ (જેમ કે તમારું ઇન્હેલર), છાતીમાં દુખાવા માટેની દવાઓ અથવા બંને.
- તમારો સેલફોન અને ચાજર.
- અખબારો જેવી નાની ખરીદી માટે તમારે ફક્ત પૈસાની જરૂર પડશે.
- જો તમારી પાસે કોઈ વ્યક્તિગત વસ્તુ છે, તો તેના માટે એક કવર. યશ્મા અથવા કોન્ટેક્ટ લેન્સ, કોઈ પણ શર્વાણ ઉપકરણો, દાંતર, કૃતિર્મ ઉપકરણો, વિગ અને ધામિરૂક વસ્તુઓ એ વ્યક્તિગત વસ્તુઓના ઉદાહરણો છે.
- તમારું આરોગ્ય સંભાળ પરોક્ષી ફોમર્ અને અન્ય આગોતરી સૂચનાઓ, જો તમે તેમને ભયાર હોય.
- તમારું શ્વાસ લેવાનું ઉપકરણ સ્લીપ એપનિયા (જેમ કે તમારું સીપીએપી મશીન) માટે જો તમે તેનો ઉપયોગ કરો. જો તમે તેને લાવી શકતા નથી, તો અમે તમને તમારા હોસ્પિટલમાં રોકાણ દરમિયાન ઉપયોગ માટે એક આપીશું.

જ્યારે તમે આવો ત્યારે શું અપેક્ષા રાખવી

ઘણા ડોક્ટરો, નસોર્ અને અન્ય સ્ટાફના સભ્યો તમને તમારું નામ અને જન્મ તારીખ બોલવા અને લખવાનું કહેશે. આ તમારી સલામતી માટે છે. આ જ નામના અથવા તેના જેવા નામના બીજા લોકોની પણ આ દિવસે પરકિર્યા કરવાની હોઈ શકે છે.

એક વખત તમને ઓપરેશન પહેલાંના વિસ્તારમાં લાવવામાં આવ્યા બાદ તમને હોસ્પિટલનું ગાઉન અને પહેરવા માટે લપસો નહિ તેવાં મોજાં મળી જશે. જો તમારી પાસે કોઈ શર્વાણ ઉપકરણો, દાંતર, કૃતિર્મ ઉપકરણો, વિગ અને ધામિરૂક વસ્તુઓ હોય તો તેને કાઢવા માટે કહેવામાં આવશે.

નસર્ સાથેની મુલાકાત

તમારા ઓપરેશન પહેલાં તમે એક નસર્ને મળશો. તેમને જણાવો કે તમે મધ્યરાતિર (રાતરે 12 વાગ્યે) પછી કઈ દવા લીધી છે અને તમે તેને કેટલા વાગ્યે લીધી છે. પિર્સિક્સ્પ્રશન અને ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ, પેયો અને કરીમનો સમાવેશ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

તમારી નસર્ તમારી ભુજા અથવા હાથની નસમાં ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) લાઇન મૂકશે, સિવાય કે તમારી પાસે પહેલેથી જ હોય:

- સેન્ટર્લ વેનસ કેથેટર (સીવીસી) અથવા અન્ય પરકારની સીવીસી .

- પેરિફેરલ લી ઇન્સ્ટેર્ડ સેન્ટર્લ કેથેટર (પીઆઇસીસી).
- પરત્યારોપિત કરાયેલું પોટર્ (જેને મેડિપોટર્ અથવા પોટર્-એ-કેથ પણ કહેવામાં આવે છે).

તમારા ઓપરેશન દરમિયાન તમને એનેસ્થેસિયા (ઊંઘ પરેરક દવા) આપવામાં આવશે. તે IV લાઇન, સીવીસી, પીઆઇસીસી લાઇન અથવા પરત્યારોપિત પોટર્ દ્વારા આપવામાં આવશે. તમે તમારા ઓપરેશન પહેલાં આઇવી લાઇન, સીવીસી, પીઆઇસીસી લાઇન અથવા પરત્યારોપિત કરેલા પોટર્ મારફતે પણ પરવાહી મેળવી શકો છો.

એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ સાથેની મુલાકાત

તમે એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jist) સાથે પણ મુલાકાત કરશો.

એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ એનેસ્થેસિયાની વિશેષ તાલીમ ધરાવતા ડૉક્ટર છે. તેઓ તમને તમારા ઓપરેશન દરમિયાન એનેસ્થેસિયા આપશે. તેઓ નીચે મુજબનું કાયર્ પણ કરશે:

- તેમની સાથે તમારા તબીબી ઇતિહાસની સમીક્ષા કરો.
- પૂછો કે શું તમને ભૂતકાળમાં એનેસ્થેસિયાથી કોઈ સમસ્યા આવી છે. આમાં ઉબકા (તમને ઉલટી થાય છે તેવું લાગવું) અથવા પીડાનો સમાવેશ થાય છે.
- તમારા ઓપરેશન દરમિયાન તમારી અનુકૂળતા અને સલામતી વિશે તમારી સાથે વાત કરશે.
- તમને કયા પરકારનું એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવશે તે વિશે તમારી સાથે વાત કરશે.
- એનેસ્થેસિયા વિશેના તમારા પરશ્નોના જવાબ આપશે.

ડૉક્ટર સાથે મુલાકાત કરો

તમારા ઓપરેશન પહેલાં, તમે આઇઆર ડૉક્ટરને મળશો જે પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મૂકશે. તેઓ તમને પરકિર્યા સમજાવશે અને તમારા પરશ્નોના જવાબ આપશે. તમને સંમતિ પતર્ક પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે કહેવામાં આવશે, જે કહે છે કે તમે ઓપરેશન માટે સંમત છો અને જોખમોને સમજો છો.

ઓપરેશન રૂમમાં

તમારી સંભાળ ટીમના એક સભ્ય તમને ઓપરેશન ટેબલ પર અને સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં લાવવામાં મદદ કરશે. તે તમને તમારી IV લાઇન, સીવીસી, પીઆઇસીસી લાઇન અથવા પરત્યારોપિત પોટર્ મારફતે એનેસ્થેસિયા આપશે. બેભાન કરવાથી તમને ઉંઘ આવે છે અને આરામદાયક લાગે છે.

ત્યારબાદ, તેઓ તમારા પેટ (પેટ)ને જીવાણુનાશક દર્વાણથી સાફ કરશે, જે જંતુઓ અને બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે. તે પછી, તેઓ તમને સ્થાનિક એનેસ્થેટિક આપશે જેથી તે વિસ્તારને સુન્ કરી શકાય જ્યાં તેઓ પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મૂકશે. તમને એનેસ્થેટિક ઇન્જેક્શન (શોટ) તરીકે મળશે.

એક વખત સ્થાનિક એનેસ્થેટિક અને બેભાન કરવાની પરકિર્યા કાયર્ત થઈ જાય પછી તમારા આઈઆર ડૉક્ટર

આ ઓપરેશન શરૂ કરી દેશે. તેઓ નિવેશિકા મૂકવામાં મદદ કરવા માટે ફ્લોરોસ્કોપી (રીઅલ-ટાઇમ એક્સ-રે) અથવા અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો ઉપયોગ કરશે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ એ એક ઇમેજિંગ સ્કેન છે જે તમારા શરીરની અંદરના ચિત્રો બનાવવા માટે ધ્વનિ તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે.

તમારા ડોક્ટર તમને કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઇનું ઇન્જેક્શન પણ આપી શકે છે. ડાઇ તે વિસ્તારને જોવાનું સરળ બનાવે છે જ્યાં નિવેશિકા મૂકવામાં આવશે.

તેઓ તમારી નિવેશિકા મૂકશે તે પછી તમારા આઇઆર ડોક્ટર નિવેશિકાની ફરતે સિલિકોન ડિસ્ક મૂકશે (આકૃતિ 4 જુઓ). આ ડિસ્ક ચીકણા (ચોટી જાય એવા) ડરેસિંગનો ઉપયોગ કરીને તમારી ત્વચા પરની નિવેશિકાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે. નિવેશિકાને તેની જગ્યાએ જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થવા માટે ટાંકા પણ લેવામાં આવી શકે છે.

તમે તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મેળવ્યા પછી

તમારા ઓપરેશન પછી, તમારી સંભાળ ટીમના એક સભ્ય તમને પોસ્ટ-એનેસ્થેસિયા કેર યુનિટ (પીએસીયુ)માં લઈ આવશે. જ્યારે તમે શામક દવાની અસર પૂરી થાય પછી જાગો છો ત્યારે નસર્ તમારી તપાસ કરશે અને તમારી સંભાળ લેશે.

તેઓ તમારા શરીરના તાપમાન, ઘબકારા, બ્લડ પ્રેશર અને ઓક્સિજનના સ્તરનું નિરીક્ષણ કરશે. તેઓ કોઈપણ રક્તસર્વાવ માટે તમારી નિવેશિકાના સ્થાનનું પણ નિરીક્ષણ કરશે. શામક દવાની અસર પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તમારે પથારીમાં રહેવાની જરૂર રહેશે. મોટાભાગના લોકો ઓછામાં ઓછી 1 કલાક માટે પીએસીયુમાં રહે છે.

તમારી ઓપરેશન પછી તમને થોડી પીડા થઈ શકે છે. જો તમે તેમ કરો છો, તો તમારી પીડાને ઓછી કરવા માટે તમારી નસર્ પાસે દવા માગો.

મોટાભાગના લોકો કે જેમણે નવી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા લગાવ્યા છે તેઓએ આખી રાત હોસ્પિટલમાં જ રોકાઈ ગયા છે. જો તમારે આખી રાત રોકાવાની જરૂર નથી, તો તમે તમારા ઓપરેશનના તે જ દિવસે હોસ્પિટલમાંથી નીકળી શકો છો.

તમે હોસ્પિટલ છોડતા પહેલાં તમારી નસર્ અને તમારા સંભાળકર્તા સાથે ડિસ્ચાર્જની સૂચનાઓની સમીક્ષા કરશે. તેઓ તમને તમારી નિવેશિકાની સંભાળ રાખવા માટે સમાન પણ આપશે. તેઓએ તમને 2 અઠવાડિયા સુધી ચાલવા માટે પૂરતો પુરવઠો આપવો જોઈએ. વધુ પુરવઠો મેળવવા અંગેની માહિતી માટે “તમારા પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા સપ્લાયનો ઓડર્સ કેવી રીતે આપવો” વિભાગ વાંચો.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા વિશે

તમારી નિવેશિકા પર સિલિકોન ડિસ્કની ટોચ પર કાળી શાહીનું નિશાન હશે (આકૃતિ 4 જુઓ). તમારી નસર્ તમને એ બતાવશે.

આ નિશાન હંમેશા ડિસ્કના ઉપરના ભાગથી સરખા અંતરે હોવું જોઈએ. જો તે બદલાય છે, તો આનો અર્થ એ છે કે નિવેશિકા ખસી ગયી છે. તમારે તમારા આઈઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરવાની જરૂર પડશે જેથી ત્યાં કોઈ તેને ચકાસી શકે.

આકૃતિ 4. ડિસ્કની ઉપર કાળી શાહીનું નિશાન




આકૃતિ 4. ડિસ્કની ઉપર કાળી શાહીનું નિશાન

તમારી નિવેશિકાનો બાહ્ય (બહારનો) છેડો 3-માગીર્ય સ્ટ્રોકપોક સાથે જોડાયેલો હશે (આકૃતિ 5 જુઓ). તેને 3-વે સ્ટ્રોકપોક કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં જોડાણના 3 બિંદુઓ (જેને પોટર્ કહેવામાં આવે છે) છે. તેમાં એક નળ પણ છે જે નિવેશિકામાંથી પસાર થતા પર્વાહીની દિશાને નિયંત્રિત કરવા માટે ફેરવી શકાય છે.

નિકાલ બેગ તમારી નિવેશિકાની સામેના પોટર્ સાથે જોડાયેલ હશે. કેન્દ્રીય પોટર્ પર એક સુરક્ષાત્મક કવર છે, જેનો ઉપયોગ તમે પર્વાહી દાખલ કરવા માટે કરી શકો છો. આ કવરને સોયરહિત કનેક્ટર કહેવામાં આવે છે.

આકૃતિ 5. 3-માગીર્ય સ્ટ્રોકપોક

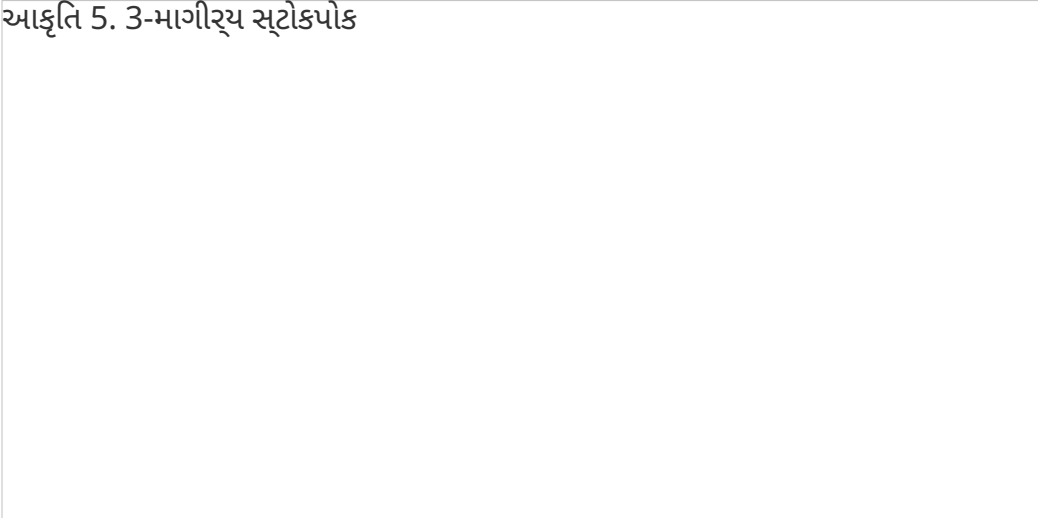

આકૃતિ 5. 3-માગીર્ય સ્ટ્રોકપોક

તમારી પાસે એક ડરેઇનેજ બેગ રહેશે જે તમારી કેથેટર સાથે જોડાયેલ રહેશે. તમે બેગની અંદર પિત્ત (લીલા-પીળા રંગનું પર્વાહી) વહેતું જોઈ શકશો. તમારા ઓપરેશન પછી 1 થી 2 દિવસ સુધી પિત્ત લોહિયાળ દેખાઈ શકે છે.

સમય જતાં, તે સોનેરી પીળો અથવા લીલો થઈ જશે, જે તમારા શરીરની અંદર નિવેશિકા ક્યાં છે તેના પર આધાર રાખે છે.

નિકાલ બેગ સલામતી પિનથી તમારા કપડાંના કમરપટ્ટા સાથે જોડી શકાય છે. અથવા, તેને વેલક્રો® પટ્ટાઓ વડે તમારા પગ સુધી સુરક્ષિત કરી શકાય છે. બેગના નીચેના ભાગમાં એક ટ્રિવસ્ટ કેપ (નિકાલ પોટર્) છે, જેનો ઉપયોગ તમે બેગને ખાલી કરવા માટે કરશો.

કેથગરીપ® એક એવું ઉપકરણ છે જે તમારી નિવેશિકાને તેની જગ્યાએ રાખવામાં મદદ કરે છે. જો તમે ભૂલથી તેને ખેંચશો તો તે તમારી નિવેશિકાને તમારા શરીરમાંથી બહાર આવવા દેશે નહીં. કેથગરીપ તમારી નિવેશિકા અને નળીને ખેંચતા, લંબાવતા અથવા વાળતા (વળાંક લેતા અથવા વળી જતા) અટકાવવામાં મદદરૂપ થશે.

તમારી પિતૃત નિકાલ નિવેશિકાની સંભાળ રાખવી

તમારા કેથેટરની સાર-સંભાળ કેવી રીતે લેવી તે તમારી નસર્ તમને શીખવશે. તમે જે શીખ્યા તેને યાદ કરવા ઘરમાં આ રિસોર્સનો ઉપયોગ કરો.

જો જરૂરી હોય તો, તમારી સંભાળ ટીમ મુલાકાતી નસર્ને તમારા ઘરે પહોંચવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે તમારી સાથે કામ કરી શકે છે. આ નસર્ મુલાકાતી નસર્ સેવાની હશે, એમએસકેની નહીં. જ્યાં સુધી તમે અથવા તમારા સંભાળકર્તાને તે જાતે કરવાનું યોગ્ય ન લાગે ત્યાં સુધી તેઓ તમને તમારી નિવેશિકાની સંભાળ લેવામાં મદદ કરશે.

દરરોજ તમે આટલું કરશો:

- તમારી નિવેશિકાની ચકાસો.
- સાદા પાણી વડે કેથેટરને સાફ કરશો.
- નિકાલ બેગમાંથી નિકાલ ખાલી કરો.
- તમે કરેલ નિકાલની માત્રા લખો.

તમારે અઠવાડિયામાં એકવાર તમારી ડ્રેસિંગ અને નિકાલ બેગ બદલવી જ જોઈએ. જો તમારું ડ્રેસિંગ ઢીલું, ભીનું અથવા ગંદુ થઈ જાય, તો તમારે તેને પણ બદલવાની જરૂર પડશે. જો તમારું ડ્રેસિંગ ભીનું થઈ જાય અને તમે તેને જેમ છે તેમ છોડી દો, તો તમારી ત્વચા બળી શકે છે અને દુખાવો થઈ શકે છે.

તમારી ડ્રેસિંગ અને નિકાલ સિસ્ટમ બદલવામાં તમારી સહાય માટે તમારે કોઈની જરૂર પડી શકે છે. તમે તમારી નિવેશિકાને ચકાસી શકશો અને તેને જાતે જ સામાન્ય ક્ષારથી ફૂલશ કરી શકશો.

તમારી નિવેશિકામાંથી બહાર આવતા પરવાહીનું પરમાણ હંમેશાં એકસરખું ન હોઈ શકે. જો તમે 1 દિવસમાં 500 મિલિલિટર (એમએલ)થી વધુ પાણીનો નિકાલ કરો છો, તો તમારા આઈઆર ડોક્ટર સાથે વાત કરો.

તેઓ તમને કહેશે કે તમે નિકાલમાં ગુમાવી રહ્યા છો તે પરવાહી અને ક્ષારને બનાવવા માટે શું પીવું જોઈએ. હંમેશની જેમ, હાઇડ્રેટેડ રહેવું (પુષ્કળ પરમાણમાં પરવાહી લેવું) અને સંતુલિત આહાર લેવો મહત્વપૂર્ણ છે.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકાને કેવી રીતે તપાસવી

તમારે દરરોજ તમારી નિવેશિકાને તપાસવી જ જોઈએ. તમે આ કામ હાથમાં રાખી શકાય તેવા અરીસા, પૂણર્ લંબાઈના અરીસા અથવા બંનેનો ઉપયોગ કરીને કરી શકો છો.

1. તે યોગ્ય સ્થિતિમાં છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે, કાળી શાહીનું નિશાન શોધો (આકૃતિ 4 જુઓ). તે હંમેશાં ડિસ્કની ટોચથી સમાન અંતરે હોવું જોઈએ. જો અંતર બદલાય છે, તો આનો અર્થ એ છે કે નિવેશિકા ખસી ગઈ છે. તમારા આઈઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો જેથી ત્યાં કોઈ તેને ચકાસી શકે.
2. ડ્રેસિંગ સુરક્ષિત છે કે નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેને ચકાસો. જો ડ્રેસિંગ ભીનું, ગંદુ, ઢીલું હોય અથવા તમારી ત્વચાથી દૂર ખસી રહ્યું હોય તો તેને બદલો.
3. જ્યારે તમે ડ્રેસિંગ બદલી રહ્યા હોવ ત્યારે તમારી નિવેશિકાની આસપાસની ત્વચાને જુઓ. તે સારી સ્થિતિમાં છે તે જોવા માટે તપાસો. ત્વચા પર લાલાશ, ત્વચા પર ચીરા અથવા ચકામાના નિશાન ન હોવા જોઈએ. તમારી નિવેશિકાની આસપાસ કોઈ પરવાહી લિક ન થવું જોઈએ.
4. નિકાલ બેગમાં રહેલા પિત્તને જુઓ. તે બેગમાં મુક્તપણે વહેતું હોવું જોઈએ. જે રીતે એ કામ કરતું દેખાય છે એમાં કોઈ ફેરફાર કરવો જોઈએ નહીં. જો પિત્ત ઓછું હોય અથવા પિત્તનો રંગ બદલાય છે, તો તમે પૂરતા પરમાણમાં પરવાહી પીતા ન હોવ તેવું બની શકે છે. દરરોજ 8 (8-ઑસ) કપ પરવાહી પીવાનો પર્યત્ન કરો.
5. નિવેશિકા અને નિકાલ બેગને નળીમાં આંટી (વળાંક અથવા ગુંચ) માટે ચકાસો. જો કોઈ આંટી હોય તો તેને સીધી કરો. જો તમે તેને સીધી ન કરી શકો તો તમારા આઈઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો.

જો તમને કોઈ સમસ્યા દેખાય, તો પહેલાં તમારી નિવેશિકાસંભાળ પૂરી કરો અને પછી તમારા આઈઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકાને કેવી રીતે ફ્લશ કરવી

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકાને કેવી રીતે ફ્લશ કરવી તે માટે એક વીડિયો બતાવવામાં આવ્યો છે.



Please visit www.mskcc.org/gu/cancer-care/patient-education/video/how-flush-your-biliary-abscess-drainage-catheter to watch this video.

તમારે તમારી નિવેશિકાને દરરોજ 2 વખત સામાન્ય ક્ષારથી ફ્લશ કરવી આવશ્યક છે. તમારા આઈઆર ડૉક્ટર તમને જણાવશે કે તમારે 3 એમએલ, 5 એમએલ અથવા 10 એમએલ ક્ષારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે નહીં.

1. તમારી વસ્તુને સ્વચ્છ, સપાટ સપાટી પર ગોઠવો. તમને જરૂર પડશે:
 - 1 (10 મિલી) પહેલાથી ભરેલ નોમરલ સલાઇન સીરિંજ
 - 1 આલ્કોહોલ વાઇપ
 - કચરાપેટી
2. તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સંપૂર્ણરૂપે ધોઈ લો અથવા આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોઈ રહ્યા છો, તો તમારા હાથને ગરમ પાણીથી ભીના કરો અને સાબુ લગાવો. તમારા હાથને 20 સેકન્ડ સુધી ધસો, પછી ધોઈ નાખો. તમારા હાથને કાગળના ટુવાલથી લુંછી નાખો. નળને બંધ કરવા માટે તે જ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે તમારા હાથના તમામ ભાગોને તેનાથી ઢંકાયેલ છે. તમારા હાથ સૂકાય ત્યાં સુધી ધસો.
3. રેપરમાંથી સામાન્ય ક્ષારવાળી સિરીંજને બહાર કાઢો. ઢાંકણને વાળીને અને ખેંચીને કાઢી લો. ઢાંકણ બંધ હોય ત્યારે, હવાને સિરીંજમાંથી બહાર કાઢો. આમ કરવા માટે, સિરીંજને ઉપરની તરફ ખુલ્લી રાખો અને જ્યાં સુધી સામાન્ય ક્ષાર ટોચ પર ન આવે ત્યાં સુધી ધીમેથી પ્લનજરને દબાવો. જો તમારા ડૉક્ટરે તમને 10 mLથી ઓછું ફ્લશ કરવાનું કહ્યું હોય, તો વધારાના ક્ષારને બહાર કાઢો. સિરીંજને ટેબલ પર મૂકો. સિરીંજની ટોચનો કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંપર્ક થવા દેશો નહીં.
4. આરામદાયક સ્થિતિમાં બેસો અથવા સૂઈ જાઓ. સ્ટોપકોકને ફેરવો જેથી નળ નિકાલ બેગ તરફ રહે (આકૃતિ 5 જુઓ).
5. સ્ટોપકોક પર આવેલા સોય વગરના કનેક્ટરને આલ્કોહોલ વાઇપ વડે સાફ કરો. તેને 15 સેકન્ડ સુધી સારી રીતે સ્ક્રૂબ કરો, પછી તેને 15 સેકન્ડ સુધી સૂકાવા દો. વાઇપને કચરાના ડબ્બામાં ફેંકી દો.
6. સિરીંજને સોયરહિત કનેક્ટરના સંપર્કમાં રહે એમ ઉપર મૂકો. જ્યારે તમે પુશ કરતા હો ત્યારે કનેક્ટરને પકડી રાખો અને તેને તેની સ્થિતિમાં સ્થિર રાખવા સિરીંજને ઘડિયાળની દિશામાં (જમણી તરફ) ફેરવો.
7. તમારી નિવેશિકાને અવરોધિત કરી શકે તેવી કોઈપણ વસ્તુને બહાર કાઢવા માટે તમારી નિવેશિકાને ઝડપથી ફ્લશ કરો. જ્યાં સુધી તમે તમારી નિવેશિકામાં બધો સામાન્ય ક્ષાર દાખલ ન કરો ત્યાં સુધી પ્લનજરને આગળ ધકેલીને આ કરો. પ્લનજરને ક્યારેય પાછળની તરફ ખેંચશો નહીં. તેને હંમેશા આગળ ધકેલો.
 - જો તમારી નિવેશિકાને ફ્લશ કરતી વખતે નીચેનામાંથી કોઈ પણ થાય, તો વધુ ક્ષારને દાખલ કરશો નહીં. પ્લનજરને ધક્કો મારવાનું બંધ કરો અને જો તમે નીચે મુજબ થાય તો તમારા આઇઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો:
 - પીડા અનુભવો.
 - ક્ષારને અંદર ધકેલવામાં તકલીફ પડે.

■ તમારી નિવેશિકાની આસપાસ પરવાહી લીક થતું જુઓ.

8. જ્યારે સિરિજ ખાલી થઈ જાય, ત્યારે તેને સોય વગરના કનેક્ટરને પકડી રાખી ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં (ડાબે) ફેરવો. સિરિજને કાઢો અને તેને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો.
9. સૂટોપકોકને પાછળની તરફ ફેરવો, જેથી નળ સોયવિહીન જોડાણ તરફ આવે (આકૃતિ 5 જુઓ). તમને કદાચ બેગમાં પરવાહી વહેતું દેખાશે.

તમારી નિકાલ બેગને કેવી રીતે ખાલી કરવી

તમારે ખાલી કરવી જોઈએ અને દરરોજ ઓછામાં ઓછી 2 વખત તમારા નિકાલને માપવું જોઈએ. જો જરૂર પડે તો તમે તેને ખાલી કરી શકો છો અને વધુ વખત માપી શકો છો.

1. તમારી વસ્તુને સ્વચ્છ, સપાટ સપાટી પર ગોઠવો. તમને જરૂર પડશે:
 - તમને હોસ્પિટલમાં મળેલ માપન પાત્ર. જો તમારા માપવાના પાત્રમાં કવર હોય તો તેને ઉતારી લો.
 - બિનજંતુરહિત ગ્લોવ્ઝ.
 - સુકો ગેઝ અથવા 1 આલ્કોહોલ વાઇપ.
 - નિકાલ લોગ અને પેન.
 - કચરાપેટી.
2. તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સંપૂર્ણરૂપે ધોઈ લો અથવા આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોઈ રહ્યા છો, તો તમારા હાથને ગરમ પાણીથી ભીના કરો અને સાબુ લગાવો. તમારા હાથને 20 સેકન્ડ સુધી ધસો, પછી ધોઈ નાખો. તમારા હાથને કાગળના ટુવાલથી લુંછી નાખો. નળને બંધ કરવા માટે તે જ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો ખાતરી કરો કે તમારા હાથના તમામ ભાગોને તેનાથી ઢંકાયેલ છે. તમારા હાથ સૂકાય ત્યાં સુધી ધસો.
3. નોન-સ્ટ્રાઇલ ગ્લોવ્ઝ પહેરી લો.
4. નિકાલ બેગને 1 હાથથી પકડી રાખો. બેગને ફ્લિપ કરો જેથી ઢાંકણ ઉપરની તરફ રહે. બેગને ખોલવા માટે ઢાંકણને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં (ડાબી બાજુએ) વાળવા માટે તમારા બીજા હાથનો ઉપયોગ કરો.
5. બેગને કાળજીપૂર્વક પાછી નીચેની તરફ પલટાવો અને પરવાહીને માપણીના પાત્રમાં ખાલી થવા દો. ઢાંકણને કન્ટેનરની બાજુઓ પર સ્પર્શ થવા દેશો નહીં.
6. જ્યારે બેગ ખાલી થઈ જાય, ત્યારે બેગને બેક પાછી ઉપર ફેરવો. ઢાંકણને બંધ કરવા માટે તેને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં (જમણી બાજુએ) ફેરવો.

7. જો કોઈ નિકાલ ઢાંકણમાં આવી જાય, તો તેને સાફ કરવાની ખાતરી કરો. તમે સૂકા ગેઝથી અથવા આલ્કોહોલ વાઇપથી ઢાંકણને સાફ કરી શકો છો. ગેઝ અથવા વાઇપને કચરાના ડબ્બામાં ફેંકી દો.
8. પાતરમાં રહેલા પરવાહીની માતરને માપો. ત્યારબાદ પરવાહીને ટોયલેટમાં ફ્લશ કરો.
9. માપન પાતરને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો. તેને હવામાં સૂકવવા દો.
10. તમારા ગ્લોવ્સ ઉતારો અને તેમને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો. પછી, તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના સ્ટેપ 2ને અનુસરો.
11. તમારા નિકાલ લોગમાં માપન પાતરમાં નિકાલની માતર લખો. **તમે આ સ્ત્રોતની પ્રિન્ટ આવૃત્તિમાં લોગને જોઈ શકો છો.** તમારા ક્ષારના ફ્લશની દૈનિક કુલ માતર (3 mL, 5 mL, or 10 mL) માંથી બાદ (ઓછું) કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

તમારા યુરેસિલ® ડ્રેસિંગને કેવી રીતે બદલવું

યુરેસિલ ડ્રેસિંગ સિસ્ટમ તમારી નિવેશિકાને તમારી પિત્ત નળીઓમાંથી બહાર નીકળતું અટકાવવામાં મદદ કરે છે. ડિસ્ક તમારી નિવેશિકામાં જોડાયેલ છે. આ ડ્રેસિંગ ડિસ્કને ઢાંકે છે જે કેથેટરને એની જગ્યાએ રાખે છે.

તમારે અઠવાડિયામાં એકવાર તમારા યુરેસિલ ડ્રેસિંગને બદલવાની જરૂર છે. જો ડ્રેસિંગ ભીનું, ગંદું, ઢીલું હોય અથવા તમારી ત્વચાથી દૂર જઈ રહ્યું હોય તો તેને બદલી નાંખો.

તમારા યુરેસિલ ડ્રેસિંગને કેવી રીતે બદલવું તેનો અહીં એક વીડિયો છે.



Please visit www.mskcc.org/gu/cancer-care/patient-education/video/how-change-your-uresil-dressing to watch this video.

તેમ છતાં તમારે તમારા ડ્રેસિંગને બદલવામાં મદદ કરવા માટે કોઈની જરૂર પડી શકે છે, તેમ છતાં તમે તમારી જાતે જ પુરવઠો એકત્રિત કરી શકો છો.

1. તમારી વસ્તુને સ્વચ્છ, સપાટ સપાટી પર ગોઠવો. તમને જરૂર પડશે:

- 1 યુરેસિલ એડહેસિવ ડ્રેસિંગ
- 3M™ નો સિટિંગ બેરિયર ફિલ્મ
- એડહેસિવ દુર કરનાર વાઇપ્સ
- આલ્કોહોલ વાઇપ્સ
- બારીક કપડું
- માઇલ્ડ સાબુ અને એક કપ પાણી

- બિનજંતુરહિત ગ્લોવ્ઝની 2 જોડી
- 1 (2 ઇંચ x 2 ઇંચ) ટેલફા™
- કાતર
- જો તમે કેથગિરપ બદલી રહ્યા હોવ તો કેથગિરપ ચેન્જિંગ કિટ
- કચરાપેટી

2. આલ્કોહોલ વાઇપથી તમારી કાતર સાફ કરો. જો તમારી ટેલફા 2 ઇંચ બાય 2 ઇંચથી મોટી હોય, તો તમારે તેને તે કદમાં કાપવી જ જોઈએ. ત્યારબાદ, તે ટુકડામાંથી એક ચીરો કાપો (આકૃતિ 6 જુઓ) અને તેને બાજુ પર ગોઠવો.

આકૃતિ 6. ટેલફામાં એક કાપો પાડો



આકૃતિ 6. ટેલફામાં એક કાપો પાડો

- આરામદાયક સ્થિતિમાં બેસો અથવા સૂઈ જાઓ. આ સમયે, તમારે તમારી મદદ માટે કોઈની જરૂર પડી શકે છે. ડ્રેસિંગ બદલનાર વ્યક્તિને નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરવા કહો.
- તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સંપૂર્ણપણે ધોઈ લો અથવા આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોઈ રહ્યા છો, તો તમારા હાથને ગરમ પાણીથી ભીના કરો અને સાબુ લગાવો. તમારા હાથને 20 સેકન્ડ સુધી ઘસો, પછી ધોઈ નાખો. તમારા હાથને કાગળના ટુવાલથી લુંછી નાખો. નળને બંધ કરવા માટે તે જ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો.
 - જો તમે આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો ખાતરી કરો કે તમારા હાથના તમામ ભાગોને તેનાથી ઢંકાયેલ છે. તમારા હાથ સૂકાય ત્યાં સુધી ઘસો.
- બિનજંતુરહિત ગ્લોવ્ઝની જોડી પર મૂકો.
- નિકાલ બેગને તેની જગ્યાએ જકડી રાખતી સેફ્ટી પિન અથવા વેલક્રો પટ્ટાને દૂર કરો. ખાતરી કરો કે નિકાલ બેગ એવી જગ્યાએ સ્થિત છે જ્યાંથી તે પડી ન શકે. તે પછી, કેથગિરપ પરના પટ્ટાઓમાંથી નિવેશિકાને મુક્ત કરો.
 - જો તમે કેથગિરપ બદલી રહ્યા હોવ, તો કેથગિરપની ધાર ફરતે એડહેસિવ રિમૂવરને સાફ કરો. આ ત્વચા પરથી દૂર કરે છે. એડહેસિવ રિમૂવર વાઇપ અને જૂની કેથગિરપને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો.

7. નિવેશિકા પર દબાણ ન આવે તે માટે 1 આંગળીની મદદથી સિલિકોન ડિસ્કને તેની જગ્યાએ પકડી રાખો. યુરેસિલ ડરેસિંગમાં સિલ્ટ્સ શોધો. આ સ્થળેથી, હળવેથી ડિસ્કને પકડો અને ત્વચામાંથી ચીકણા પદાર્થને હળવેથી દૂર કરો.

જો નિવેશિકાની આસપાસની ત્વચા સંવેદનશીલ હોય તો ડરેસિંગની કિનારીની ફરતે એડહેસિવ રિમૂવર વડે લૂછી લો. જ્યારે તમે ડરેસિંગને દૂર કરી રહ્યાં હોવ ત્યારે આ અગવડતા ઘટાડવામાં મદદ કરશે. એડહેસિવ રિમૂવર વાઈપ અને જૂના યુરેસિલ ડરેસિંગને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો.

8. તમારા ગ્લોવ્સ ઉતારો અને તેમને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો. પછી, તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના પગલા 4ને અનુસરો. જ્યારે તમારું કામ પતી જાય, ત્યારે બિનજંતુરહિત મોજાની નવી જોડી પહેરો.

9. એક ગેઝ પેડ લો અને તેમને સાબુ અને પાણીથી ભીજવો. સિલિકોન ડિસ્કની આસપાસ અને નીચેની ત્વચાને સાફ કરવા માટે ગેઝ પેડ્સનો ઉપયોગ કરો. આ જ ગેઝ પેડનો ઉપયોગ કરીને, ડિસ્કની ઉપરની અને નીચેની બાજુઓને જ સાફ કરો. જ્યારે બીજી બાજુ સાફ કરી રહ્યા હોય ત્યારે ડિસ્કની 1 બાજુને હંમેશા મજબૂતીથી પકડી રાખો.

10. નવા ગેઝ પેડથી ત્વચા અને સિલિકોન ડિસ્કને શુષ્ક કરો.

11. કોઈપણ બાકી રહેલા સાબુને દૂર કરવા માટે આલ્કોહોલ વાઇપથી સિલિકોન ડિસ્કની ટોચને સાફ કરો. આલ્કોહોલ વાઇપથી ત્વચાને સાફ કરશો નહીં. આનાથી ત્વચા શુષ્ક અને બળતરા થઈ શકે છે.

12. ડિસ્ક નિપ્પલ તરફ જુઓ. કાળી શાહીનું નિશાન ડિસ્ક નિપ્પલની બરાબર ઉપર હોવી જોઈએ (આકૃતિ 4 જુઓ). જો તે ખસી ગયું હોય, તો ડરેસિંગ બદલવાનું પૂરું કરો અને પછી તમારા આઈઆર ડોક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો.


13. સિલિકોન ડિસ્કની નીચે નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થળને ચકાસો. આ તે વિસ્તાર છે જ્યાં નિવેશિકા શરીરમાં જાય છે. જ્યારે બીજા ભાગને ડિસ્કના તળિયે જોવા માટે ઉપર તરફ નમાવી રહ્યા હોય ત્યારે ડિસ્કની 1 બાજુને હંમેશા મજબૂતીથી પકડી રાખો. જો તમને આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ દેખાય, તો ડરેસિંગ બદલવાનું પૂરું કરો અને પછી તમારા આઈઆર ડોક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો:

- લાલાશ.
- સોજો.
- નિકાલ સિસ્ટમ કે જેમાંથી દુગર્ધ આવે છે.
- પર્વાહી લીકેજ.
- નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થળની આસપાસ નવી પેશીઓની વૃદ્ધિ. આ હાનિરહિત છે, પરંતુ જો તે પીડાદાયક હોય તો તમારા આઈઆર ડોક્ટર દ્વારા તેને દૂર કરી શકાય છે.

14. સિલિકોન ડિસ્કની આસપાસની અને નીચેની ત્વચા પર 3M™ નો સિટિંગ બેરિયર ફિલ્મ મૂકો. ડિસ્કની ટોચ પર જ્યાં તમે ડરેસિંગ મૂકશો ત્યાં થોડું વધારે મૂકો. આ ત્વચાને સુરક્ષા આપે છે અને એડહેસિવને સારી રીતે

ચોટવામાં મદદ કરે છે. ખાતરી કરો કે જ્યારે તમે ડિસ્કની નીચે બેરિયર ફિલ્મ દાખલ કરો ત્યારે તમે ડિસ્કને 1 હાથની જગ્યાએ પકડી રાખો છો.

15. તમે પહેલેથી જ કાપી નાખ્યું છે તે ટેલ્ફા લો. તેને સિલિકોન ડિસ્કની નીચે નિવેશિકાની આસપાસ સરકાવો (આકૃતિ 7 જુઓ). ટેલફામાં ચીરો વ્યક્તિના પગ તરફ નીચેની તરફ હોવો જોઈએ. ટેલ્ફા ડિસ્ક નીચે ભીનાશ જમા થતી અટકાવશે.



આકૃતિ 7. કેથેટરની આસપાસ ડિસ્કની નીચે ટેલ્ફાને સરકાવવું

16. યુરેસિલ ડરેસિંગને ઉપર ઉઠાવો. કાપો ખૂલ્લો કરો અને તેને કેથેટરની આસપાસ મૂકો (જુઓ આકૃતિ 8). ટેલ્ફાના કાપાને આ કાપા સાથે એક લીટીમાં રાખો. એ સુનિશ્ચિત કરો કે ડરેસિંગ તળિયે એડહેસિવ (ચીકણું) હોય, જે ટોચ પર ચમકદાર હોય. ડિસ્કના નિપ્પલની નીચે પરંતુ ડિસ્કના ચપટા ભાગ પર ડરેસિંગ મૂકો. ડરેસિંગમાં ચીરો વ્યક્તિના પગ તરફ નીચેની તરફ હોવો જોઈએ.

આકૃતિ 8. યુરેસિલ ડરેસિંગ




આકૃતિ 8. યુરેસિલ ડરેસિંગ

17. યુરેસિલ ડરેસિંગમાં બેકિંગ પેપરના 3 ટુકડાઓ હોય છે. બેકિંગ પેપરને દૂર કરવા માટે સૌથી મોટા ટુકડાના ખૂણાથી શરૂ કરો. જ્યારે તમે ત્વચા પર એડહેસિવ લગાવો છો ત્યારે બેકિંગ પેપરને ધીમે ધીમે દૂર કરો. તેને ચીકણું કરો જેથી તે ત્વચા પર ચોટી જાય. પરેક્રિસ કરતા જશો એમ આ સહેલું થતું જશે. જો ડરેસિંગ યોગ્ય

રીતે ચોટી રહ્યું ન હોય, તો ડ્રેસિંગ અને ટેલ્ફોન ઉતારી લો. સ્ટેપ 15થી ફરી શરૂ કરો.

18. બેકિંગ પેપરના અન્ય 2 ટુકડા દૂર કરો, એક જ સમયે 1 જ . ત્વચા પર એડહેસિવને દબાવો અને તેને મુલાયમ કરો જેથી તે ત્વચાને ચોટી રહે. ડ્રેસિંગને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે ડ્રેસિંગના કાપાની કિનારોને એકબીજા પર રાખો.
19. જો તમે પણ નિકાલ બેગ અથવા કેટગ્રિપ બદલતા હોવ, તો નીચે આપેલા “સ્ટોપકોક અને નિકાલ સિસ્ટમને કેવી રીતે બદલવી” વિભાગમાં આપવામાં આવેલી સૂચનાઓને અનુસરો. જો તમે અત્યારે ડ્રેસિંગ બદલી રહ્યા હોવ, તો વેલકરો પટ્ટા અથવા સેફ્ટી પિન વડે નિકાલ બેગને સુરક્ષિત કરો. પછી, નિવેશિકાને કેથગ્રિપ સાથે ફરીથી જોડો. આમ કરવા માટે:
- નિવેશિકાને ઉપકરણના પટ્ટાઓ પર મૂકો, જેથી તે કેટગ્રિપની મધ્યમાં રહે.
 - કેથગ્રિપ પર 2 પટ્ટા છે: 1 છિદ્ર સાથે અને 1 સાથે દાંતાવાળી ધાર સાથે. કાણાંવાળા પટ્ટામાં બે ખૂલ્લા ભાગો હોય છે. બીજા પટ્ટાના નીચલા દ્વારમાં દાંતાવાળી કિનારીઓ સાથેનો પટ્ટો દાખલ કરો.
 - કેથગ્રિપમાં નિવેશિકાને સુરક્ષિત કરવા માટે ખેંચો (આકૃતિ 9 જુઓ). ખૂબ યુસ્તપણે ખેંચશો નહીં.

આકૃતિ 9. કેથેટરને CathGrip માં સુરક્ષિત કરવું

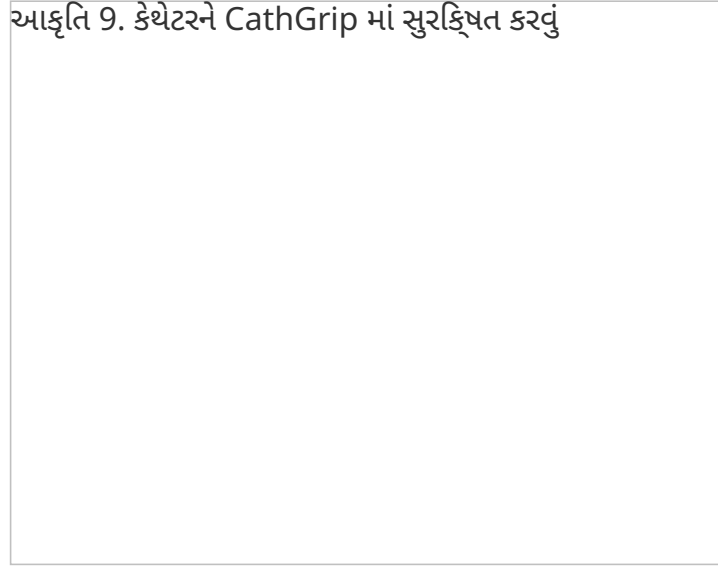

આકૃતિ 9. કેથેટરને CathGrip માં સુરક્ષિત કરવું

- ખાતરી કરો કે નિવેશિકા પર કોઈ ખેચાણ અથવા તણાવ નથી. નિવેશિકામાં સહેજ વળાંક (વકર) હોવો જોઈએ. જો નિવેશિકાને ખેંચીને અથવા યુસ્તપણે ખેંચવામાં આવી રહ્યું હોય, તો કેથેગ્રિપમાં નિવેશિકાની સ્થિતિ બદલો.
20. તમારા ગ્લોવ્સ ઉતારો અને તેમને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો. પછી, તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના પગલા 4ને અનુસરો.
21. યુરેસિલ ડ્રેસિંગ પર આજની તારીખ લખવા માટે માફર્સનો ઉપયોગ કરો. તમે છેલ્લે ક્યારે ડ્રેસિંગ બદલ્યું હતું તે આ તમને યાદ કરવામાં મદદ કરશે. તે તમને તે જાણવામાં પણ મદદ કરશે કે તમારે તેને ફરીથી ક્યારે

બદલવાની જરૂર છે.

સ્ટોપકોક અને નિકાલ ઉપકરણને કેવી રીતે બદલવું

તમારે અઠવાડિયામાં એકવાર તમારી સ્ટોપકોક અને નિકાલ સિસ્ટમ બદલવાની જરૂર રહેશે.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા પર સ્ટોપકોક અને નિકાલ સિસ્ટમ કેવી રીતે બદલવી તે માટે અહીં એક વીડિયો છે. સ્ટોપકોક અને નિકાલ સિસ્ટમને તમારી નિકાલ નિવેશિકા પર યુરેસિલ ડિસ્કથી બદલવા માટે સમાન સૂચનાઓને અનુસરો.



Please visit www.mskcc.org/gu/cancer-care/patient-education/video/how-change-stopcock-and-draining-system-your-biliary-abscess-catheter to watch this video.

1. તમારી વસ્તુને સ્વચ્છ, સપાટ સપાટી પર ગોઠવો. તમને જરૂર પડશે:

- નોન-સ્ટેરાઇલ ગ્લોવ્ઝ
- 1 સોયરહિત કનેક્ટર
- 1 સ્ટેરાઇલ 3-માગીર્ય સ્ટોપકોક
- 1 ડ્રેઇનેજ બેગ
- સેફ્ટી પિન અથવા વેલક્રો પટ્ટા
- બારીક કપડું
- એડહેસિવ રીમૂવર વાઇપ
- જો તમે કેથગિરપ બદલી રહ્યા હોવ તો કેથગિરપ ચેન્જિંગ કિટ
- કચરાપેટી

2. નિકાલ બેગ ખાલી કરો અને તમારા નિકાલ લોગમાં નિકાલની માત્રા લખો. [તમે આ સ્તરોતની પિરન્ટ આવૃત્તિમાં લોગને જોઈ શકો છો.](#) ઉપરના “તમારી નિકાલ બેગને કેવી રીતે ખાલી કરવી” વિભાગમાં આપેલા સૂચનોનું પાલન કરો.

3. તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સંપૂર્ણરૂપે ધોઈ લો અથવા આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.


- જો તમે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોઈ રહ્યા છો, તો તમારા હાથને ગરમ પાણીથી ભીના કરો અને સાબુ લગાવો. તમારા હાથને 20 સેકન્ડ સુધી ઘસો, પછી ધોઈ નાખો. તમારા હાથને કાગળના ટુવાલથી લુંછી નાખો. નળને બંધ કરવા માટે તે જ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો.

◦ જો તમે આલ્કોહોલ-આધારિત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો ખાતરી કરો કે તમારા હાથના તમામ ભાગોને તેનાથી ઢંકાયેલ છે. તમારા હાથ સૂકાય ત્યાં સુધી ઘસો.

4. સોય વગરના કનેક્ટર, 3-વે સ્પોપકોક અને નિકાલ બેગ વડે પેકેજને ખોલો. નિકાલ બેગ સાથેનું પેકેજ બાજુ પર મૂકો.
5. પેકેજ ખોલ્યા બાદ, તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના સ્ટેપ 3ને અનુસરો.
6. સોય વગરના કનેક્ટરના પાયામાંથી રક્ષણાત્મક કવરને દૂર કરો અને તેને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો. સ્પોપકોકના સેન્ટર પોર્ટ સાથે સોય વગરના કનેક્ટરને જાડો (આકૃતિ 5 જુઓ). સ્પોપકોકને નીચે મૂકો.
7. તેના પેકેજમાંથી નિકાલ બેગને બહાર કાઢો. નિકાલ બેગમાંથી ટ્યુબિંગને ફેરવીને સ્પોપકોક સાથે જાડો. તેને બંધ કરવા માટે ઢાંકણને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં (જમણી બાજુએ) ફેરવો. આ ઢાંકણને નિકાલ પોર્ટ કહેવામાં આવે છે. નિકાલ પોર્ટ બંધ કરવાથી લીકેજ થતું અટકે છે.
8. એસેમ્બલ કરેલ ડરેઇનેજ બેગને તેના પેકેજમાં રાખો. જ્યાં સુધી તમે તેને નિવેશિકાથી જોડવા માટે તૈયાર ન થાઓ ત્યાં સુધી આ તેને સાફ રાખશે.
9. તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના પગલાં 3ને અનુસરો. તે પછી, બિનજંતુરહિત ગ્લોવ્ઝ પહેરો.
10. નિકાલ બેગને તેની જગ્યાએ જકડી રાખતી સેફ્ટી પિન અથવા વેલક્રો પટ્ટાને દૂર કરો. ખાતરી કરો કે નિકાલ બેગ એવી જગ્યાએ સ્થિત છે જ્યાંથી તે પડી ન શકે. ખાતરી કરો કે નવી નિકાલ બેગ તમારી પહોંચની અંદર છે. તે પછી, કેથગિરપ પરના પટ્ટાઓમાંથી નિવેશિકાને મુક્ત કરો.
 - જો તમે કેથગિરપ બદલી રહ્યા હોવ, તો કેથગિરપની ધાર ફરતે એડહેસિવ રિમૂવરને સાફ કરો. આ ત્વચા પરથી દૂર કરે છે. એડહેસિવ રિમૂવર વાઇપ અને જૂની કેટગિરપને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો.
11. ગેઝ પેડ લો અને તેને સોય વગરના કનેક્ટરની નીચે મૂકો. જ્યારે ગેઝને પકડો, ત્યારે નિવેશિકામાંથી જૂની સ્પોપકોક અને નિકાલ સિસ્ટમને દૂર કરો. તેમને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો.
12. નવા સ્પોપકોક અને ડરેઇનેજ સિસ્ટમને જલ્દીથી જોડી દો. સ્પોપકોકનો “બંધ” નળ સોય વિનાના કનેક્ટર તરફ છે તે સુનિશ્ચિત કરો (આકૃતિ 5 જુઓ).
13. જો તમે કેટગિરપને બદલી રહ્યા હોવ, તો નવી કેટગિરપ મૂકવા માટે જગ્યા પસંદ કરો. કેથગિરપ અને નિકાલ બેગ ટ્યુબિંગ નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થળ કરતા નીચે સ્થિત હોવી જોઈએ. આનાથી તેને કાઢવામાં મદદ મળશે. ખાતરી કરો કે જ્યારે તમે ઉભા હો કે પડી રહ્યા હો ત્યારે એ બંને નીચે રહે છે. જ્યારે નિવેશિકા જોડવામાં આવે છે, ત્યારે નિવેશિકા પર કોઈ ખેચાણ અથવા તણાવ હોવું જોઈએ નહીં. નિવેશિકામાં સહેજ વળાંક (વક્ર) હોવો જોઈએ.
14. કેથગિરપ જ્યાં મૂકવામાં આવશે તે સ્થળ તપાસો. ખાતરી કરો કે તમે વિસ્તાર પસંદ કરો છો કે જે લાલ અથવા બળતરાવાળો નથી. કાતર અથવા વાળના ટરીમરથી સ્થળ પરના લાંબા વાળને કાપી નાખો. રેઝરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો, જે તમારી ત્વચાને કાપી શકે છે અને તેમાંથી લોહી નીકળી શકે છે.

15. કેથગરૂપ પેકેજને ખોલો.
16. કેટગિરૂપ ચેન્નિજંગ કિટથી આલ્કોહોલ વાઇપથી સ્થળને સાફ કરો. આ તમારી ત્વચામાંથી લોશન અથવા સાબુ જેવા તેલ અને ઉત્પાદનોને દૂર કરે છે. આગળના પગલા પર આગળ વધતા પહેલાં આલ્કોહોલને સંપૂર્ણપણે સૂકાવા દો.
17. કેથગિરૂપ ચેન્નિજંગ કિટથી સ્કિન પરેપ વડે સ્થળને સાફ કરો. આ તમારી ત્વચાને સુરક્ષિત કરે છે અને કેથગિરૂપને તમારી ત્વચા સાથે ચોટી રહેવામાં મદદ કરે છે. આગલા પગલા પર આગળ વધતા પહેલાં ત્વચાને સંપૂર્ણપણે સૂકાવા દો.
18. કેથગરૂપમાં બેકિંગ પેપરના 2 ટુકડાઓ છે. તમે બેકિંગ પેપરના દરેક ટુકડાને 1 પછી એક દૂર કરશો. મધ્યમાંથી શરૂ કરો અને કાગળને ધીમે-ધીમે કેથગિરૂપની 1 બાજુએથી દુર કરો (આકૃતિ 10 જુઓ). જ્યારે તમે કાગળને દુર કરો છો, ત્યારે તમારી ત્વચા પર એડહેસિવ દબાવો. તેને નીચે કરો જેથી તે તમારી ત્વચાને ચોટી રહે. બીજીએ બાજુએ એ પરફિચ્યા ફરીથી કરો.

આકૃતિ 10. કેથગિરૂપનું બેકિંગ પેપર દૂર કરી રહ્યા છીએ

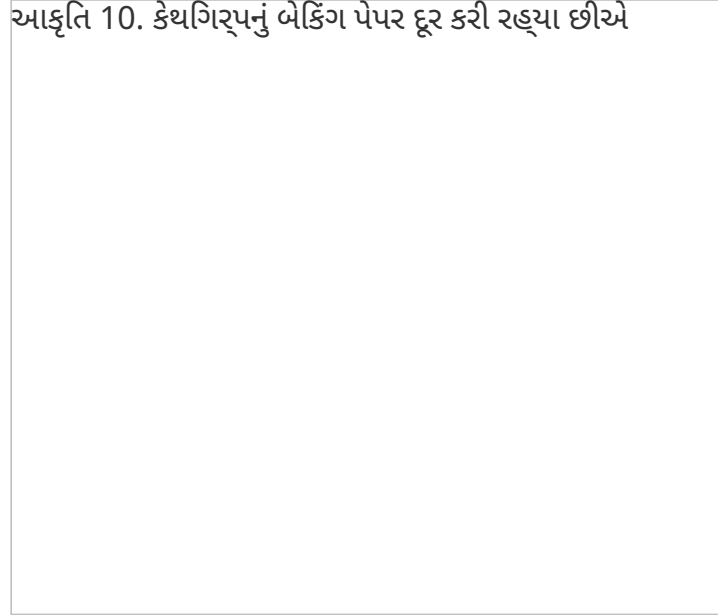


આકૃતિ 10. કેથગિરૂપનું બેકિંગ પેપર દૂર કરી રહ્યા છીએ

19. કેથગિરૂપને તમારી ત્વચા પર 5 સેકન્ડ માટે હળવેથી દબાવો. આ તેને તમારી ત્વચા પર ચોટાડી દેશે.
20. નિવેશિકાને કેથગિરૂપ સાથે ફરીથી જોડો. આમ કરવા માટે:
 - નિવેશિકાને ઉપકરણના પટ્ટાઓ પર મૂકો, જેથી તે કેથગિરૂપની મધ્યમાં રહે.
 - કેથગિરૂપ પર 2 પટ્ટા છે: 1 છિદ્ર સાથે અને 1 સાથે દાંતાવાળી ધાર સાથે. કાણાંવાળા પટ્ટામાં બે ખૂલ્લા ભાગો હોય છે. બીજા પટ્ટાના નીચલા દ્વારમાં દાંતાવાળી કિનારીઓ સાથેનો પટ્ટો દાખલ કરો.
 - કેથગિરૂપમાં નિવેશિકાને સુરક્ષિત કરવા માટે ખેંચો (આકૃતિ 9 જુઓ). ખૂબ યુસ્તપણે ખેંચશો નહીં.
 - ખાતરી કરો કે નિવેશિકા પર કોઈ ખેંચાણ અથવા તણાવ નથી. કેથેટર એકદમ હળવી ઝૂકેલ હોવી જોઈએ.

જો નિવેશિકાને ખેંચીને અથવા ચુસ્તપણે ખેંચવામાં આવી રહ્યું હોય, તો કેથેગિરપમાં નિવેશિકાની સ્થિતિ બદલો.

21. નિકાલ બેગને વેલકરો પટ્ટાથી અથવા સેફ્ટી પિન વડે સુરક્ષિત કરો. જો તમે સેફ્ટી પિનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો બેગને તમારા કપડાંના કમરપટ્ટા સાથે જોડો. જો તમે વેલકરો પટ્ટાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ, તો બેગને તમારા પગ સાથે જોડો. બેગને નિવેશિકાના સૂતરની નીચે મૂકો. આને કારણે નિવેશિકા ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે, જે નિકાલને નીચેની તરફ ખેંચે છે (આકૃતિ 11 જુઓ).

આકૃતિ 11. કેથેટરની નીચે ડરેઇનેજ બેગ

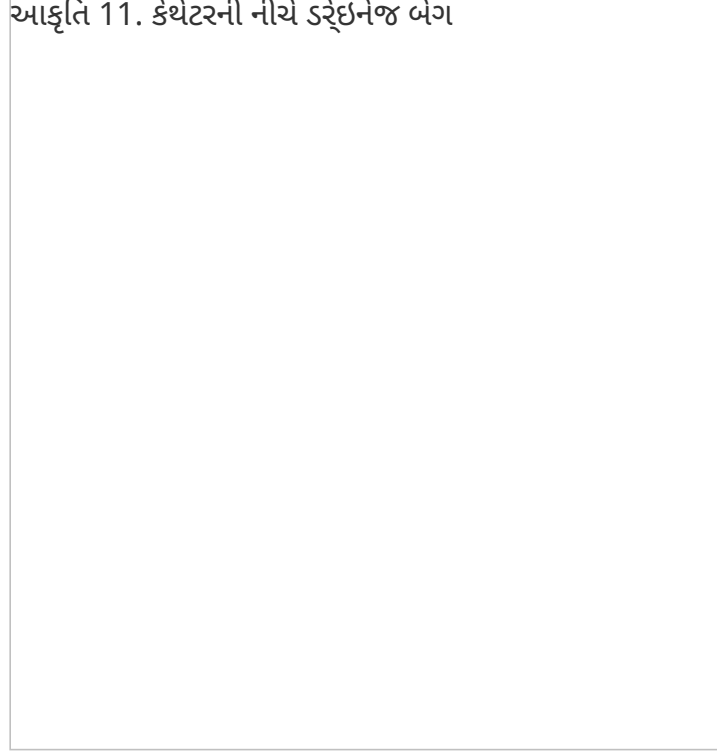

આકૃતિ 11. કેથેટરની નીચે ડરેઇનેજ બેગ

22. નવી નળીમાં પરવાહી વહી રહ્યું છે કે નહીં તે જોવા માટે ચકાસો.
23. તમારા ગ્લોવ્સ ઉતારો અને તેમને કચરાપેટીમાં ફેંકી દો. પછી, તમારા હાથને ફરીથી સાફ કરવા માટે ઉપરના પગલા 3ને અનુસરો.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા સાથે કેવી રીતે સ્નાન કરવું

તમે સ્નાન લઈ શકો છો. જ્યારે તમારી પાસે તમારી નિવેશિકા હોય ત્યારે સ્નાન ન કરો.

તમે સ્નાન કરો તે પહેલાં, તમારી નિકાલ બેગને પકડેલા બેલ્ટ અથવા ઇલાસ્ટિક બેન્ડને દૂર કરો. નિકાલ બેગ ખાલી કરો. તે પછી, નિકાલ બેગને નિવેશિકાની નજીક તમારા શરીર પર ચોટાડો. જો તમે ઇચ્છો, તો તમે બેગને તમારી કમર અથવા પિંડી સાથે જોડવા માટે વેલકરો પટ્ટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તમારી નિવેશિકા પરના ડરેસિંગને ક્યારેય ભીનું ન કરો. તમે સ્નાન કરો પહેલાં, તમારા ડરેસિંગને એક્વાગાડર્® જેવા એક વખત વાપરી શકાય તેવા વોટરપ્રૂફ કવરથી ઢાંકી દો. તમે વોટરપ્રૂફ કવર ઓનલાઇન ખરીદી શકો છો. જો તમારી પાસે વોટરપ્રૂફ કવર ન હોય તો તેને સૂકવવા માટે તમારા ડરેસિંગની ઉપર ટેપ પ્લાસ્ટિક રેપ અથવા ગેલન સાઇઝની બેગ મૂકો.

વોટરપ્રૂફ કવર પર મૂકવા માટે:

1. ઉપરથી અને બાજુની પટ્ટીઓને દુર કરો.
2. ટોચની ધારને તમારા ડરેસિંગની ઉપર મૂકો. વોટરપ્રૂફ કવરની ટેપને તમારા ડરેસિંગને સ્પર્શવા દેશો નહીં. જ્યારે તમે સ્નાન કર્યારૂં પછી વોટરપ્રૂફ કવર ઉતારો છો, ત્યારે તે તમારા ડરેસિંગને ઉપર લઈ શકો છો. તમારા ડરેસિંગ પર કવરને લીસું બનાવો.
3. નીચેનીની પટ્ટીને દુર કરો. વોટરપ્રૂફ કવરની નીચેની ધાર તમારા ડરેસિંગની નીચે હોય તે સુનિશ્ચિત કરો. તમારી નિવેશિકાને વોટરપ્રૂફ કવરમાં મૂકો જેથી તે સંપૂર્ણરૂપે ઢાંકાઈ જાય.
4. વોટરપ્રૂફ કવરની તળિયાની ધારને નીચેની તરફ લીસી કરો.

જ્યારે તમે સ્નાન કરતા હોવ, ત્યારે તમારું ડરેસિંગ સૂકું રાખો. હેન્ડહેલ્ડ શાવરહેડનો ઉપયોગ કરવાથી પાણીને ડરેસિંગથી દૂર રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.

15 મિનિટથી વધુ સમય સુધી સ્નાન કરશો નહીં. હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો, પણ ગરમ પાણીનો નહીં. આ વોટરપ્રૂફ કવરને બહાર આવતા અટકાવવામાં મદદ કરશે.

તમારા સ્નાન પછી, તરત જ વોટરપ્રૂફ કવરને કાઢી નાખો. ખાતરી કરો કે તમારું ડરેસિંગ સ્વચ્છ અને કોરું છે. જો તે ગંદુ કે ભીનું હોય તો તેને બદલી નાખો. ભીનું ડરેસિંગ એ ત્વચાની સમસ્યાઓ માટેનું સામાન્ય કારણ છે.

જ્યારે તમારી પાસે પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા હોય ત્યારની પરવૃત્તિઓ

- તમે કામ પર જઈ શકો છો અને તમારા કેથેટર લગાવેલ હોય એ સ્થિતિમાં કસરત કરી શકો છો. એવી હિલચાલ ટાળો જેમાં એક બાજુથી બીજી બાજુ ખેંચવાનો સમાવેશ થાય છે. એવી પરવૃત્તિઓ ટાળો જ્યાં તમારે ઝૂકવું પડે. આ રીતે આગળ વધવાથી તમારી નિવેશિકાને વિસ્થાપિત (ખસી) શકે છે.
- તમારી નિવેશિકા પાણીમાં ડૂબેલી (પાણીની અંદર) ન હોવી જોઈએ. તરવું નહીં, સ્નાન ન કરવું, ન તો ગરમ ટબનો ઉપયોગ કરવો. જો તમે વેકેશનનું આયોજન કર્યું હોય તો તમારા આઈઆર ડૉક્ટર સાથે વાત કરો. જ્યારે તમે દૂર હોવ ત્યારે તેઓ તમને તમારી નિવેશિકા સંભાળની યોજના બનાવવામાં મદદ કરશે.
- તમારા શરીર પર કેટગિરપથી હંમેશાં ટ્યુબિંગને સુરક્ષિત કરો. ખાતરી કરો કે નિવેશિકા પર કોઈ ખેચાણ અથવા

તાણાવ નથી. કેથેટર એકદમ હળવી ઝૂકેલ હોવી જોઈએ. જો નિવેશિકાને ખેંચીને અથવા ચુસ્તપણે ખેંચવામાં આવી રહ્યું હોય, તો કેથેગિરપમાં નિવેશિકાની સ્થિતિ બદલો.

- જ્યારે તમે કપડાં પહેરી રહ્યા હોવ, ત્યારે ખાતરી કરો કે તમે તમારી નિવેશિકાને ખેંચશો નહીં. પેન્ટીહોઝ અથવા બેલ્ટ જેવા કાપડ વડે ટ્યુબિંગને સંકોચાવા દેશો નહીં.
- સૂતી વખતે કેથેટર ઉપર શરીર આવી ન જાય એવો પર્યાસ કરો. આ તમારી નિવેશિકાને સંકોચાતા અટકાવશે.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકામાં નિયમિત ફેરફાર

પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા મોટે ભાગે દર 8થી 12 અઠવાડિયે (2થી 3 મહિના) બદલવામાં આવે છે. તમારા આઇઆર ડૉક્ટર તમને વધુ કે ઓછી વખત આવવાનું કહી શકે છે. તમે તમારી રીતે કેથેટરને નિયમિત રીતે બદલવાની અપોઇન્ટમેન્ટ મેળવી શકો છો. અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે તમારા આઇઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં સમય કરતાં ઓછામાં ઓછા 3 અઠવાડિયા વહેલા કોલ કરો.

આંતરિક-બાહ્ય પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા માટે વિશેષ સૂચનાઓ

જો તમારી પાસે આંતરિક-બાહ્ય પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા હોય, તો તમારા આઇઆર ડૉક્ટર તમને કેપિંગ ટેસ્ટ કરાવવાની ઇચ્છા રાખી શકે છે. તેઓ પરીક્ષણ દરમિયાન તમારી નિવેશિકાને બંધ કરશે. તમારી નિવેશિકાને બંધ કરવાથી તમારા પિત્તને તમારા શરીરમાં નિવેશિકા મારફતે ખસેડવામાં મદદ મળે છે. જો તમે પરીક્ષણ પાસ કરો છો, તો તમારે નિકાલ બેગની જરૂર રહેશે નહીં (આકૃતિ 13 જુઓ).

આકૃતિ 13. કેપ ચઢાવેલ બાઇલરી ડ્રેઇનેજ કેથેટર



આકૃતિ 13. કેપ ચઢાવેલ બાઇલરી ડ્રેઇનેજ કેથેટર

તમે ઘરે જાઓ તે પહેલાં તમારી નિવેશિકા હોસ્પિટલમાં બંધ થઈ શકે છે. મોટે ભાગે, થોડા દિવસો સુધી ઘરે રહ્યા પછી, તમારે તમારી નિવેશિકાને જાતે બંધ કરવું પડશે.

તમારી નિવેશિકાને કેવી રીતે બંધ કરવું તે અંગેની સૂચનાઓ માટે *How to Cap Your Biliary Drainage*

તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાને ક્યારે કોલ કરવો

જો તમારી પાસે નીચેનામાંથી કોઈ પણ હોય તો તમારા આઈઆર ડૉક્ટરને કોલ કરો:

- તમને 100.4 °F (38 °C) અથવા તેથી વધુ તાવ હોય છે.
- તમારી નિવેશિકામાંથી કોઈ નિકાલ નથી, અથવા નિકાલની માત્રા સામાન્ય કરતા ઘણી ઓછી છે.
- ડરેઇનેજમાં લોહી જેવું દેખાય.
- નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થાન આસપાસ લિકેજ છે.
- તમે તમારી નિવેશિકાને ફ્લશ કરી શકતા નથી અથવા જ્યારે તે ફ્લશ થાય છે ત્યારે તે લીક થાય છે.
- કાળી શાહીના નિશાનનું સ્થાન બદલાઈ ગયું છે.
- જ્યારે 3-વે સ્ટોપકોક સીધી સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તમારી નિવેશિકામાંથી કોઈ નિકાલ નથી.
- 3-વે સ્ટોપકોક તૂટી ગયો છે અથવા ખુલી ગયો છે.
- નળીમાં આંટી છે જેને તમે સીધી કરી શકતા નથી, જેના કારણે બ્લોકેજ થાય છે.
- તમને બ્લોકેજના લક્ષણો છે, જેમ કે તમારી નિવેશિકામાંથી પીડા અથવા લિકેજ.
- તમને નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થાન પર દુખાવો, મૃદુતા અથવા સોજો છે.
- નિવેશિકા દાખલ કરવાના સ્થાનની આસપાસની ત્વચા લાલ, બળતરા અથવા તે સામાન્ય રીતે જે રીતે દેખાય છે તેનાથી અલગ દેખાય છે.
- ઉબકા (એવું લાગે છે કે તમને ઉલટી થશે).
- તમને નવો કમળો અથવા કમળો છે જે વધુ ખરાબ થઈ રહ્યો છે.
- તમને તમારી નિવેશિકા વિશે કોઈપણ પરશ્નો અથવા ચિંતાઓ છે.

સંપર્કની માહિતી

જો તમને કોઈ પણ પરશ્નો અથવા ચિંતાઓ હોય, તો તમારા આઈઆર ડૉક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો. તમે તેમને સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કોલ કરી શકો છો. સાંજે 5 વાગ્યા પછી, શનિ-રવિમાં કે રજાના દિવસે 212-639-2000 પર કોલ કરો. કોલ પર ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી ફેલો માટે પૂછો.

તમારી પિત્ત નિકાલ નિવેશિકા વસ્તુઓનો ઓડર્સ કેવી રીતે

આપવો

જ્યારે તમે ઘરે જશો, ત્યારે તમારી સંભાળ ટીમ તમને 2 અઠવાડિયા સુધી ચાલે તેટલી વસ્તુ પુરવઠો આપશે. જ્યારે તમને વધુ વસ્તુની જરૂર હોય, ત્યારે તમે તમારી મુલાકાતી નસર્ સેવા દ્વારા તેમને ઓડર આપી શકો છો. જો તમે તમારી મુલાકાતી નસર્ સેવા મારફતે વસ્તુ મંગાવી શકતા ન હો, તો તમારા આઇઆર ડોક્ટરની ઓફિસમાં કોલ કરો. અહીં તમને જોઈતી વસ્તુઓની યાદી આપવામાં આવી છે:

વસ્તુ	પૂરી પાડેલ વસ્તુઓ
3-વે સ્ટોપકોક	1-1
એડહેસિવ રિમુવર	1 બોક્સ
આલ્કોહોલ વાઇપ્સ	1 બોક્સ
CathGrip	1-1
નિકાલ ડિસ્ચાર્જ કિટ (4-અઠવાડિયા માટે વસ્તુ)	1 કીટ
સોયરહિત કનેક્ટર	1-1
નોન-સ્ટ્રાઇલ ગ્લોવ્ઝ	1 બોક્સ
સાદું બારીક પાતળું કાપડ	1 પેકેજ
સ્કિન પરેપ	1 બોક્સ
ટેલ્કા	1-1
યુરેસિલ એડહેસિવ ડ્રેસિંગ	1 બોક્સ
યુરેસિલ ડ્રેઇનેજ બેગ	1-1

પરીફિલ્ડ (પહેલાથી ભરેલ) સીરિજ

પરી-ફિલ્ડ નોમર્લ સલાઇન સીરિજ માટે પિર્સિક્શનની જરૂર પડશે. તમે IR ક્લિનિક પરથી પિર્સિક્શન મેળવી શકશો.

જો તમારી સ્થાનિક ફાર્મસીમાં સિરિજ ન હોય, તો તમે તેને મેમોરિયલ હોસ્પિટલની બહારની ફાર્મસીમાંથી મેળવી શકો છો. તે સોમવારથી શુક્રવાર સુધી, સવારે 9 થી સાંજે 5:45 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે. ફાર્મસી સુધી પહોંચવા માટે 646-888-0730 પર કોલ કરો.

એમએસકે પાસે અન્ય સ્થળોએ રિટેલ ફાર્મસીઓ પણ છે. તમારી નજીક એમએસકે રિટેલ ફાર્મસી શોધવા માટે www.msk.org/locations/visiting-us/retail-pharmacy ની મુલાકાત લો.

નિકાલ લોગ

